


放射線被ばく線量

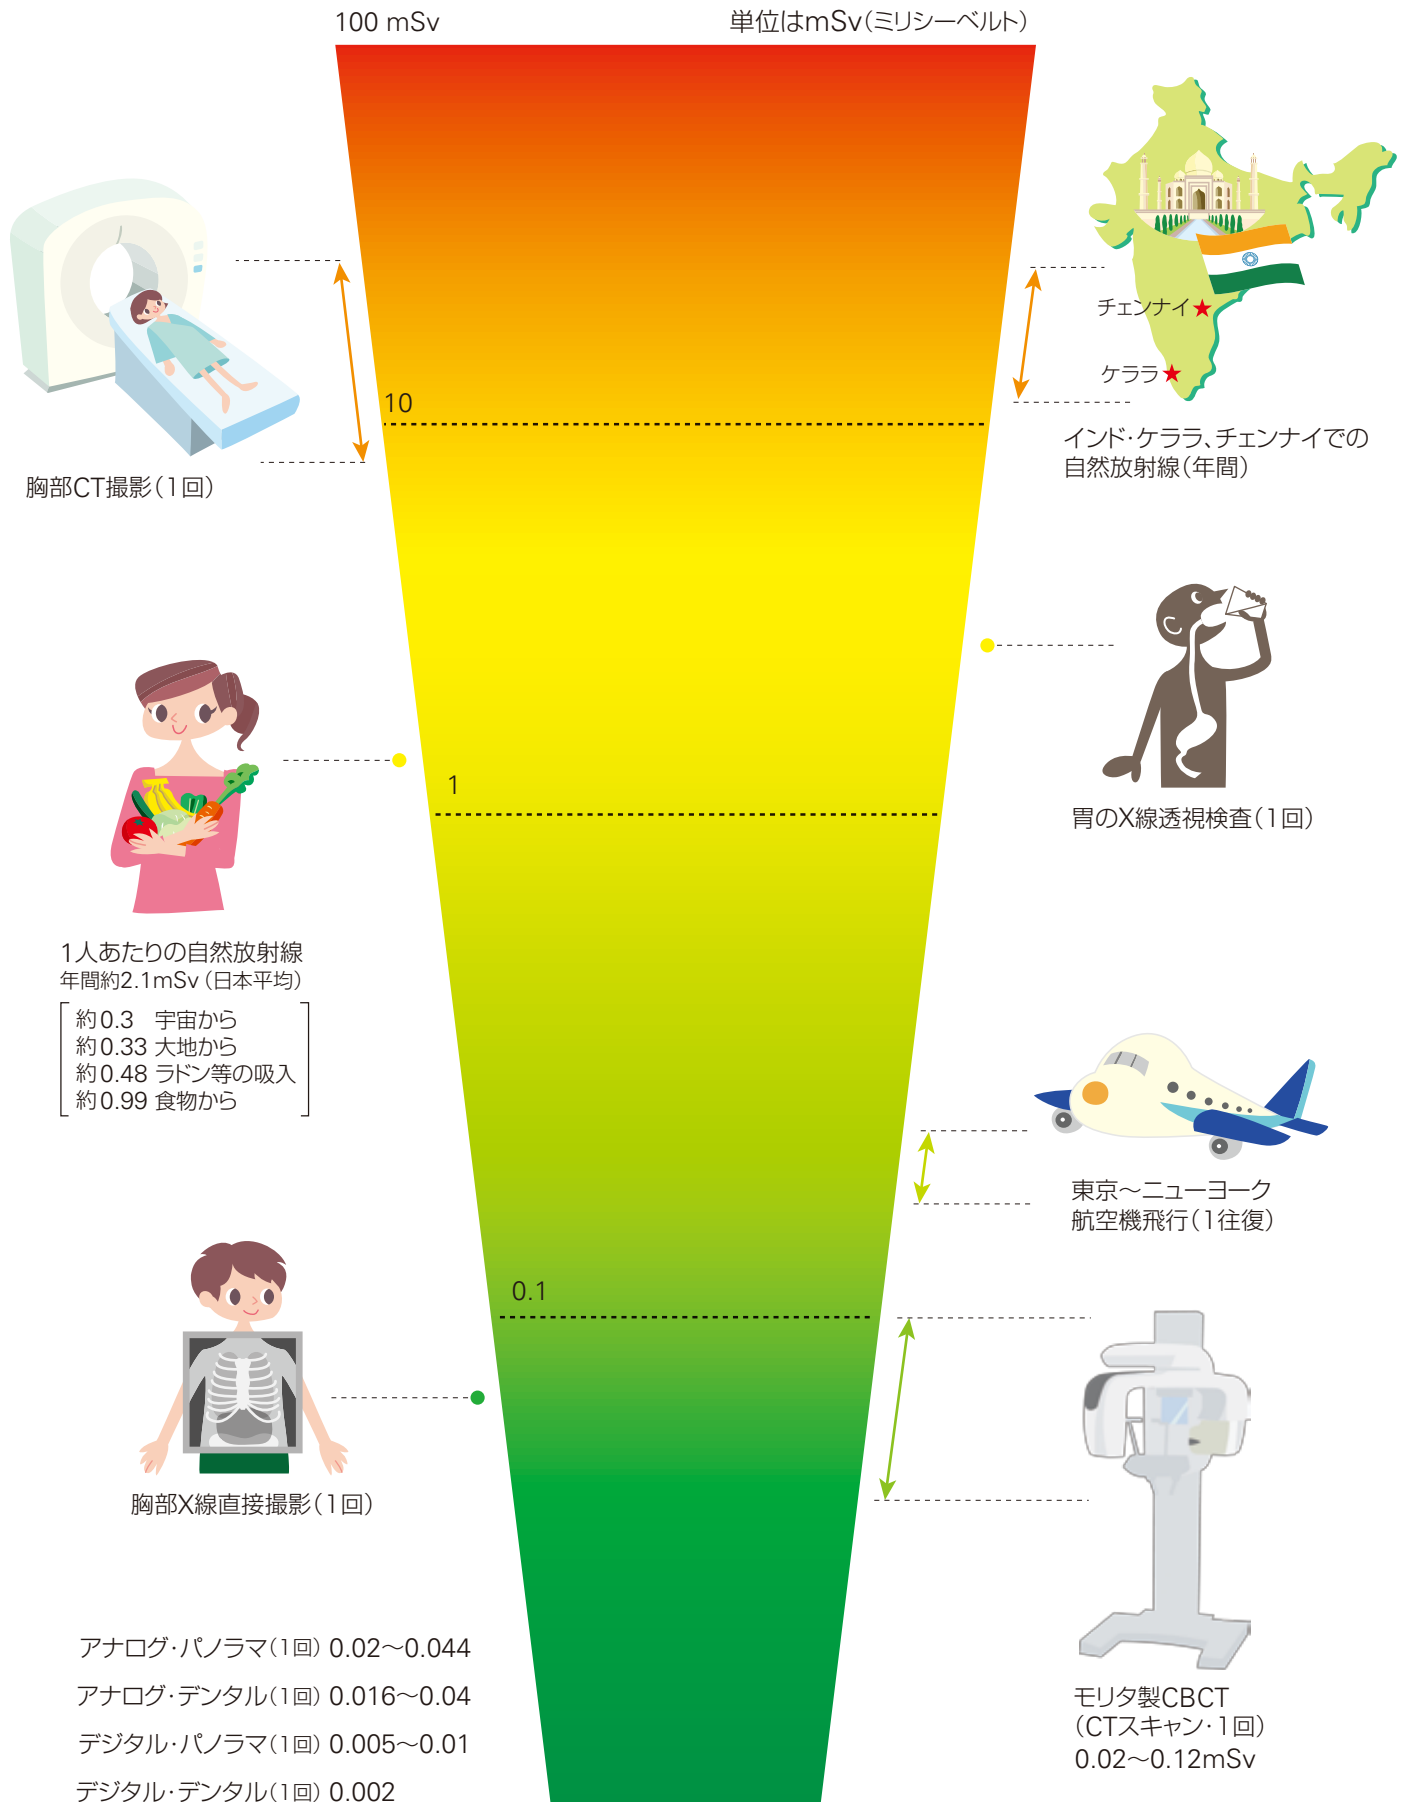

●ICRP Pub.13 2007年勧告の負荷係数により推定値を算出 ●医療被ばくは使用機種や撮影条件により線量が異なります
●モリタ製作所HPより抜粋 <http://www.morita.com/global/cms/website.php?id=/jp/index.htm>
※一人当たりの年間自然放射線量については、国立研究開発法人放射線医学総合研究所資料を参考